


## X-Act ROM

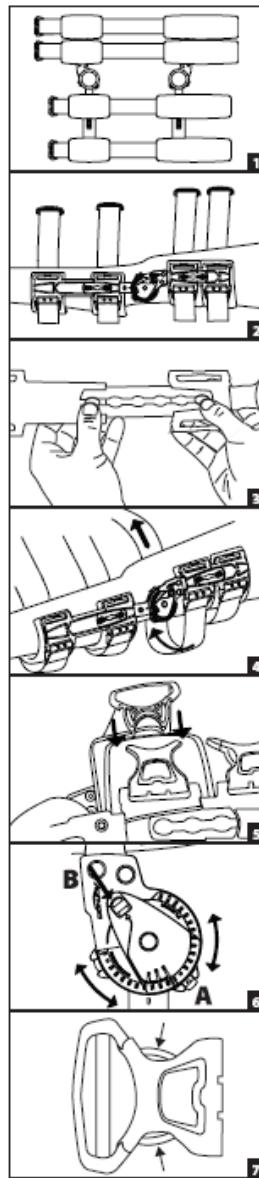

قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات التالية بشكل كامل ويتمنع. الاستعمال الصحيح أمر حيوي من أجل عمل الجهاز بشكل سليم.

هدف الاستعمال/دلائل الاستعمال: للتنبيت و مجال حرکية محمي مرتبط بعمليات جراحية في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، الرباط الصليبي الخلفي (PCL)، الرباط الجانبي الخارجي (LCL)، الرباط الجانبي الداخلي (MCL) وتصليحات الهلالة. لقد تم تصميم هذا المنتج لتكمة مجموعة من العلاجات الطبية الشائعة للألام المذكورة أعلاه. ينبغي تحديد ضبط مجال الحرکية، تكرر و مدة الاستخدام من قبل أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف الداعمة

موانع الاستعمال: لا يوجد

تحذيرات واحتياطات: إذا عانيت من أي ألم، تورم، تغيرات بالإحساس، أو أي ردود فعل غير عادية أثناء استخدام هذا المنتج، استشر على الفور أخصائي الرعاية الطبية الذي يعالجك.

معلومات حول الاستعمال:

- .1 فات أطراف الحزام بجوار الأبازيم السوداء وفتح الدعامة لتصبح مسطحة بواسطة سحب العمودين بعيداً عن بعضهما.
- .2 وضع الساق على الدعامة المسطحة. ينبغي وضع العمود الأقصر على الفخذ. عدل الدعامة حتى يصبح كل عمود متراصفاً مع خط الوسط بجوانب الساق الإنسانية والجانبية.
- .3 افتح المحراك التاسكوبى للطول المرغوب من خلال الضغط زر القطعة المنزلقة حتى الوصول للطول المرغوب. تأكيد من أن القضيبين متباينين بالطول وأن كل محراك حزام معلم على نفس الموقع على كل عمود، على التوالي.

.4

- عدل أطوال الحزام:
- حرر الحزام من العمود
- بواسطة سحب الحزام بعيداً عن الجسم، تخلص من الجزء المتذلي على الجزء الخلفي من الدعامة
- اربط الحزام بالعمود ثانية لحفظه على الطول
- تأكيد من أن العمدان متراصفة على الجهة الإنسانية والجانبية من الساق

.5 اشبك كل واحد من مشابك الإبازيم الأسود بالقطعة المنزلقة حتى سماع صوت "كليك". شد الأحزمة بواسطة عن طريق سحب الطرف السائب. تخلص من الحزام الزائد وصح وضعية طرف الحزام التمساحي لحافة الحزام الجديدة.

اربط طرف الحزام بإحكام على الحزام.

A) عدل المفصلة من خلال الضغط على أزرار الثنائي والتمديد للداخل وقم بتدوير كباس التوقف حتى تترافق الزاوية المطلوبة مع مركز الزر. حرر زر الضغط وتأكيد من تراجعه كلياً للوضع الممدوّد.

B) استخدم ميزة الإقفال السريع بالزوايا 0، 15، أو 30 درجة، عن طريق تحريك زر الإقفال السريع الأحمر للداخل حتى يشغل القفل. تأكيد من عدم دوران الأعمدة. إذا كانت هناك حاجة لوضع إقفال آخر، راجع الخطوة 7 وتأكد من تحديد زر الثنائي وكذلك زر التمديد على نفس تعين الزاوية.

7. لخلع الدعامة، حرر كل واحد من الأبازيم. وعندها يمكن لبس الدعامة ثنائية كوحدة واحدة.

تعديلات أخرى:

قد تنتهي قضبان العلاقة لتضيق تعارض للقوس أو المرفق. اثنين كل قضيب برفع قضيب الفخذ/بطنة الساق بقوة مقابل السطح الصلب واستخدم واضغط باستمرار على العلاقة في الاتجاه المطلوب. اثنين كل قضيب جانبي بنسبة متساوية فوق الكوع والعلاقة. لتسهيل الاستخدام بعد العمليات الجراحية، أو قبل المطابقة المنشد قبل عملية الجراحة إذا ذلك كان ممكناً.

تعليمات التنظيف:

اغسل البطانات الاسفنجية باليد بمياه باردة (30 درجة مئوية) مع مادة تنظيف معتدلة. اشطفها جيداً.

جففها في الهواء فقط، لا تسخنها.

يوصى بتنظيف المكونات بشكل منتظم.

استشر طبيبك أو المعالج دائمًا قبل إجراء تغييرات بالدعامة.

كلالة: بإطار كفالة DJO, LLC سينم نصائح أو استبدال كل الوحدة أو جزء منها وكذلك ملحقاتها بسبب عيوب بالمادة أو بجودة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ البيع.

التركيب: بولي بروپيلين 30%، المنيوم 40%， نايلون 25%，

درلين 3%， فولاذ مقاوم للصدأ 2%.

مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

RX فقط

غير مصنوع من لاتكس مطاط طبيعي

ملاحظة: في حين تم بذل كل الجهد في أحدث التقنيات للحصول على أفضل توافق من حيث الأداء، القوة، المتانة والراحة، إلا أن هذا الجهاز هو عامل واحد فقط في برنامج العلاج الذي يعرضه أخصائي الرعاية الطبية. لا يوجد ما يضمن منع الإصابات من خلال استخدام هذا المنتج.

تنبيه: يحدد القانون الفدرالي (الولايات المتحدة) يحدد بيع هذا الجهاز بواسطة أو بطلب من أخصائي رعاية صحية مرخص